




SISTEMA DI RILASCIO PRECARICATO AUTOMATIZZATO CLAREON® AUTONOME®

Pronto all'uso in 3 semplici step^{*,1}


STEP 1:
Riempire con
materiale
viscoelastico
(~0,28 mL)




Prima dell'uso, attendere 30 minuti per lasciare che il viscoelastico raggiunga la temperatura presente in sala operatoria¹



STEP 2:
Rimuovere il
sistema di
blocco



STEP 3:
Far avanzare lo
stantuffo per
piegare la IOL



Un "clic" indica che la cartuccia di CO₂ è stata attivata e lo stantuffo è pronto



Ispezionare visivamente la lente per determinare la posizione delle anse anteriore e posteriore



IMPORTANTE:
Eeguire l'impianto entro **1 minuto** dopo che la IOL ha raggiunto la posizione di pausa¹

Le istruzioni per l'uso di Alcon sono ora disponibili online



Visitare www.ifu.alcon.com

1


Selezionare la regione e/o il Paese

2

Eeguire la ricerca per codice prodotto o nome prodotto

3

Selezionare la lingua delle IFU (34 lingue disponibili)

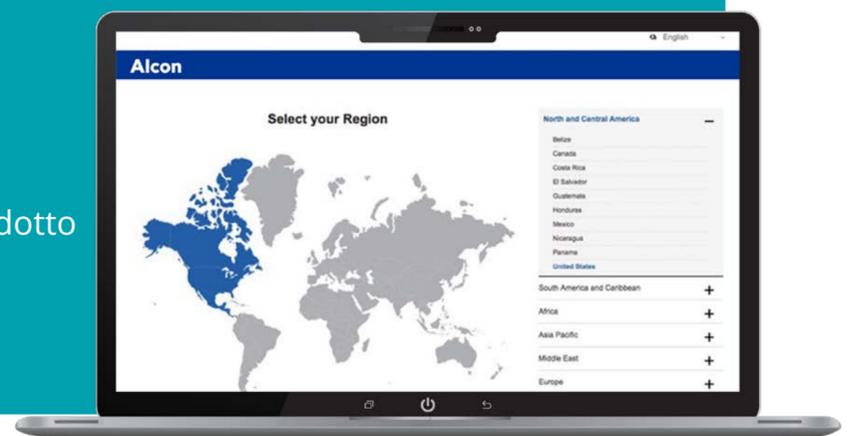

Come richiedere una copia cartacea delle IFU?



Mandare un'e-mail a ifu.request@alcon.com

1. Inserire il nome prodotto e/o il codice prodotto
2. Stampare le IFU allegate alla risposta ricevuta per e-mail



^{*}Si rimanda alle Istruzioni per l'uso del sistema di rilascio precaricato automatizzato Clareon® AutoNoMe® per le indicazioni complete passo-passo.
¹Nei mercati specifici che richiedono IFU cartacee, la confezione della IOL sarà confezionata insieme a una copia cartacea nella lingua locale.
1. Istruzioni per l'uso del sistema di rilascio precaricato automatizzato Clareon® AutoNoMe®.